PROMOTAL

fidji

Divan d’examen

10110-10

Manuel d’utilisation

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

CE

Modèle présenté : 10110-10

Identification produit du propriétaire

(les renseignements ci-dessous sont requis lors d'un appel du service après-vente)

Nom du modèle :

Numéro de Série :

Date d'acquisition :

Nom du propriétaire / Organisation :

Nom du fournisseur :

Numéro de téléphone du fournisseur :

Société de service après-vente agréée Promotal :

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

Les descriptions et les spécifications contenues dans le présent Manuel d'utilisation sont jugées exactes au moment de l'impression.
Promotal se réserve cependant le droit de modifier sans préavis ses modèles et ses procédures ou de les rendre caducs.

Table des matières

Information importante 6

Symboles de sécurité *6*

Notice d’installation 7

Matériel livré sous emballage cartonné *7*
Matériel fixe, mobilier, mobilier mural *7*
Matériel livré non monté *7*
Matériel livré sur palette bois *7*
Condition de stockage *8*
Déballage *8*
Représentant CE autorisé *8*

Notice d’instructions 9

Avertissement *9*
Maintenance *9*
Notice d’entretien *9*
Matériel peint *9*
Revêtement simili cuir *9*
Matériel en inox *10*
Matériel chrome *10*
Matériel en PVC/ABS *10*
Élément stratifié *10*

Modèles 11

Dimensions *11*

Notice d’utilisation – divan d’examen 12

Caractéristiques *12*
Utilisation prévue *12*

Montage du plan de couchage 13

Utilisation du divan 14

Réglage de l’inclinaison de la têtière *14*
Rouleau papier *14*
Installation du porte rouleau *14*
Mise en place du rouleau papier *15*
Réglage des patins *15*

Accessoires 15

Étaux ***15***

Mise en place des étaux *15*

Repose-bras ***16***

Réglage des appui-bras *16*

La paire d'étriers ***16***

Mise en place des étriers *16*

La paire d'appui-jambes ***16***

Mise en place des appui-jambes *16*

Porte sérum 2 crochets ***17***

Mise en place du porte-sérum *17*

Porte sérum 2 crochets ***17***

Réglage en hauteur du porte-sérum *17*

Mise en place du porte-sérum *17*

Les barrières ***18***

Mise en place des barrières *18*

Utilisation de la barrière *18*

Appui-tête ***19***

Rallonge de dossier ***19***

Installation du rallonge de dossier *19*

Appui-tête ***20***

Installation de l'appui-tête *20*

Porte rouleau réglable ***21***

Installation du porte rouleau *21*

Installation du porte rouleau [avec la présence de l'appui-tête] *22*

Mise en place du rouleau papier *23*

Porte rouleau ***23***

Installation du porte rouleau *23*

Mise en place du rouleau papier *23*

Coupe papier ***24***

Mise en place du coupe papier *24*

Utilisation du coupe papier *25*

Options 25

Trou pour visage ***25***

Durée de vie du divan d'examen 26

Composants interchangeables d'usures ***26***

Maintenance obligatoire / spécifique ***26***

Suivi d'entretien ***27***

Notes 28

Renseignements sur la garantie 30

Garantie *30*

Engagement 30

Exclusions 30

Obligation exclusif 30

Absence d'autorisation 30

Déclaration de conformité 31

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

Information importante

Symboles de sécurité

Attention
Signale un danger potentiel qui doit être évité, sous peine de blessures graves.

Avertissement matériel
Signale un danger potentiel qui doit être évité, sous peine d'endommagement du matériel

Remarque
Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.

Consulter le guide de l'utilisateur pour des renseignements importants.

Conserver au sec

Orientation correcte pour transport

Nombre maximum de palettes empilées

Fragile

Norme de certification

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

Conditionnement du matériel

Matériel livré sous emballage cartonné

○ *Matériel de faible encombrement, léger, ou offrant des possibilités de préhension aisées*

Dans ce cas, la manutention se fait facilement sans dispositif de levage, en veillant à bien respecter le sens de positionnement des cotés. En l'absence de flèche signalétique indiquant le haut et le bas, se repérer au positionnement des différentes étiquettes d'identification du produit qui sont toujours situées en partie haute.

○ *Matériel lourd, volumineux, nécessitant l'emploi d'un dispositif de levage*

Dans ce cas, l'emploi d'un chariot élévateur est possible sous réserve d'une utilisation correcte de celui-ci. Avant tout déplacement, il faut veiller au sens de positionnement du matériel et s'assurer que la charge est bien équilibrée.

Matériel fixe, mobilier, mobilier mural

Après le retrait de l'emballage carton, retirer toute protection éventuelle restante, et installer le matériel.

Pour le mobilier mural, s'assurer de la bonne installation du dispositif : fixation au mur adaptée, mise de niveau.

Pour les autres produits, procéder à l'installation en s'assurant de la bonne stabilité du matériel.

Sur les modèles qui en sont pourvus, des patins de réglage permettent d'améliorer cette stabilité et d'assurer une mise à niveau.

Si le matériel est équipé d'accessoires non installés, les mettre en place en respectant les notices de montage jointes (étagères, porte verre, taquets).

Matériel livré non monté

Ce matériel vous est livré à monter.

Les différents éléments qui composent ce matériel sont protégés par un emballage fait :
– d'une protection plastique (vinyle)
– d'une protection en film bulle /mousse ou polystyrène
– d'un emballage carton.

Matériel livré sur palette bois

Le matériel positionné sur une palette en bois peut aisément être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur, sous réserve d'une utilisation correcte de celui-ci. Avant tout déplacement, s'assurer du bon positionnement du chariot par rapport à la palette, et de la bonne stabilité de l'ensemble.

Il faudra tout particulièrement être vigilant à la manutention du matériel de grande hauteur (type armoire).

Conditions de stockage

Température ambiante :	-5 °C à +38 °C (+23 °F à 100 °F)
Humidité relative :	10 % à 90 % (sans condensation)
Pression atmosphérique :	0.5 bar à 1.05 bar (500 hPa à 1060 hPa)

Tout stockage doit se faire en respectant les recommandations suivantes :

- Local propre, aéré et tempéré.
- Matériel stocké à l'abri des intempéries et de l'ensoleillement direct.
- Local non humide.
- Matériel stocké à l'abri des chocs.
- (ne pas entreposer dans un endroit soumis à de fréquents passages).
- Empilement de tout matériel à proscrire.
- Conservation dans l'emballage d'origine jusqu'à la destination finale.

Déballage

Lors de l'installation, enlever toutes les agrafes et retirer l'emballage carton avec précaution. Des éléments fragiles du matériel (revêtement, carter en matière plastique, etc.) peuvent se trouver à proximité de celui-ci. Attention aux outils coupants.

Une fois l'emballage ôté, retirer toute protection éventuelle restante.

Cas de l'emballage sur palette. Retirer l'emballage comme précédemment. Suivant les modèles, l'immobilisation du matériel est assurée soit par des brides vissées, soit par des tasseaux bois cloutés. Utiliser une clé (dans le cas des brides métalliques). Utiliser un arrache clou (dans le cas des tasseaux bois). Déposer le matériel de la palette et enlever les protections restantes, le matériel peut être alors utilisé.

Remarque :

Représentant CE autorisé

Au sein de l'Union Européenne, tous les problèmes, plaintes ou questions doivent être adressés au représentant CE autorisé de Promotal indiqué ci-dessous :

Promotal
22, Rue De St. Denis
53500 Ernée,
FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 430 517 76
Fax : + 33 (0)2 430 572 00

Instructions

Avertissement

Toute manipulation du Dispositif Médical ne doit s'effectuer qu'après une lecture complète du manuel d'utilisation. L'appareil n'est destiné qu'à l'utilisation spécifique prévue et décrite dans notre documentation. Le montage et raccordement ne doivent se faire que par du personnel qualifié. En aucun cas les composants électriques (Vérin, boîtier, coffret, poignée de commande, batterie, adaptateur, etc.) ne doivent être ouverts. PROMOTAL décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions.

Maintenance générale

En dehors d'un nettoyage régulier et approprié, nos produits ne nécessitent pas d'entretien particulier. Les mécanismes de blocage mécanique (arc lisse, compas cranté, crémaillère, etc.) ne demande pas d'attention spécifique. Les ressorts à gaz qui équipent nos tables ne nécessitent aucun entretien. Leur tige doit rester propre, ne pas subir de chocs importants, et ne pas être nettoyée avec des produits corrosifs. Les vérins électriques et hydrauliques équipant nos tables ne requièrent pas d'attention particulière.

Les tables, divans, fauteuils et chariots à hauteur variable sont équipés soit :

- De bras munis de bagues d'articulations lubrifiées à vie.
- De glissières télescopiques à billes. Dans ce cas, une lubrification annuelle peut être envisagée (notamment en cas de déplacements bruyants) à l'aide de graisse ordinaire (Voir plan de démontage pour l' accès aux glissières).

Notice d'entretien

Matériel peint (finition époxy polyester)

L'emploi de produit de nettoyage courant du commerce, type produit pour vitres, convient tout à fait au nettoyage du matériel recouvert d'un revêtement époxy polyester. **Produits Strictement prohibés :**

– Solvants :	Essence Alcools supérieurs : – Aliphatiques – Aromatiques Cétones - esters Tri -perchlorethylène	**– Bases :**	Soude 10 % Ammoniaque 10 %	**– Divers :**	Eau distillée Eau de Javel Poudres abrasives Tout produit d'entretien abrasif
		– Acides :	Nitrique 30 % Chlorhydrique 30 % Citrique 10 %		

Revêtement simili cuir

Utiliser une éponge humide et de l'eau savonneuse (type savon de Marseille). Pour les tâches rebelles, essuyer par tamponnage sans frotter, avec un tissu imprégné de white spirit ou une solution d'eau et d'alcool (pourcentage inférieur à 30-%).

Produits Strictement prohibés : Alcool pur, acétone, perchloréthylène, trichloréthylène, tous solvants et détergents, Produits d'entretien abrasif, toutes sortes de cires.

Classement non feu : Tous nos revêtements sont classés M2 ou M1. Sur demande, nous pouvons vous fournir les attestations des fabricants.

Matériel en inox

Nettoyage et Entretien : L'entretien du matériel en acier inoxydable se limite à un nettoyage périodique de leur surface. Ce nettoyage est indispensable, ne serait-ce que pour leur maintien en état de propreté, mais c'est en général une opération simple, grandement facilitée par les qualités de surface des aciers inoxydables. Une large gamme de produits et méthodes de nettoyage peut être utilisée. Le choix du produit le mieux adapté sera guidé par la nature des salissures ou du produit contenu et par les conditions d'utilisation des éléments en acier inoxydable.

Produits de nettoyage

a) **Détergents - lessives :** Tous les types de détergents, lessives et savons du commerce sont généralement utilisables, à condition qu'ils ne contiennent pas de produits chlorés.

b) **Poudres abrasives :** Ces produits peuvent rayer les surfaces d'acier inoxydable et donc en modifier l'aspect, au moins localement. Elles sont donc à proscrire.

c) **Solvants :** L'utilisation de solvants peut être utile pour l'élimination de produits gras. Les solvants usuels (benzène, chlorure de méthylène, white spirit, etc.) ainsi que les produits domestiques ou industriels spécialement préparés peuvent être utilisés. Leur emploi impose, bien entendu, des précautions, du fait de leur inflammabilité et de leur toxicité. Des précautions sont également à prendre pour éviter la détérioration des matériaux adjacents qui peuvent être sensibles à leur action (peinture, mastics, joints, etc.).

d) **Produits acides :** Le vinaigre (acide acétique) peut être utilisé pour l'enlèvement de taches provoquées par des dépôts calcaires. Son maintien au contact des surfaces doit être d'une durée limitée et son emploi suivi d'un rinçage abondant et soigné à l'eau claire. L'utilisation de produits chlorés est proscrite.

e) **Bases :** Elles sont formellement proscrites.

Divers : l'emploi de laine d'acier ou d'éponges métalliques est formellement proscrit.

Matériel chrome

Ce matériel à été revêtu d'une couche de chrome pour le protéger de l'oxydation.

Nettoyage et Entretien : Il est impératif, pour ne pas endommager cette couche de protection, de ne pas utiliser de produits abrasifs et/ou corrosifs. L'emploi de produits de nettoyage courant du commerce, type produit pour vitres convient tout à fait au nettoyage du matériel chromé. Si nécessaire un produit désinfectant approprié peut être utilisé sur le chrome (bien respecter les précautions d'emploi).

Matériel en PVC/ABS

Nettoyage et Entretien : L'emploi de produit de nettoyage venant du commerce, type produit pour vitres, convient tout à fait aux matières PVC ou ABS. Pour donner de l'éclat à un produit ancien et terni, il est possible d'utiliser des produits rénovateurs pour plastiques. Attention l'emploi de tous solvants et de tous produits abrasifs est à proscrire.

Élément stratifié

Nettoyage et Entretien : Idem que pour PVC, utiliser du produit pour vitres.

Modèles

Dimensions

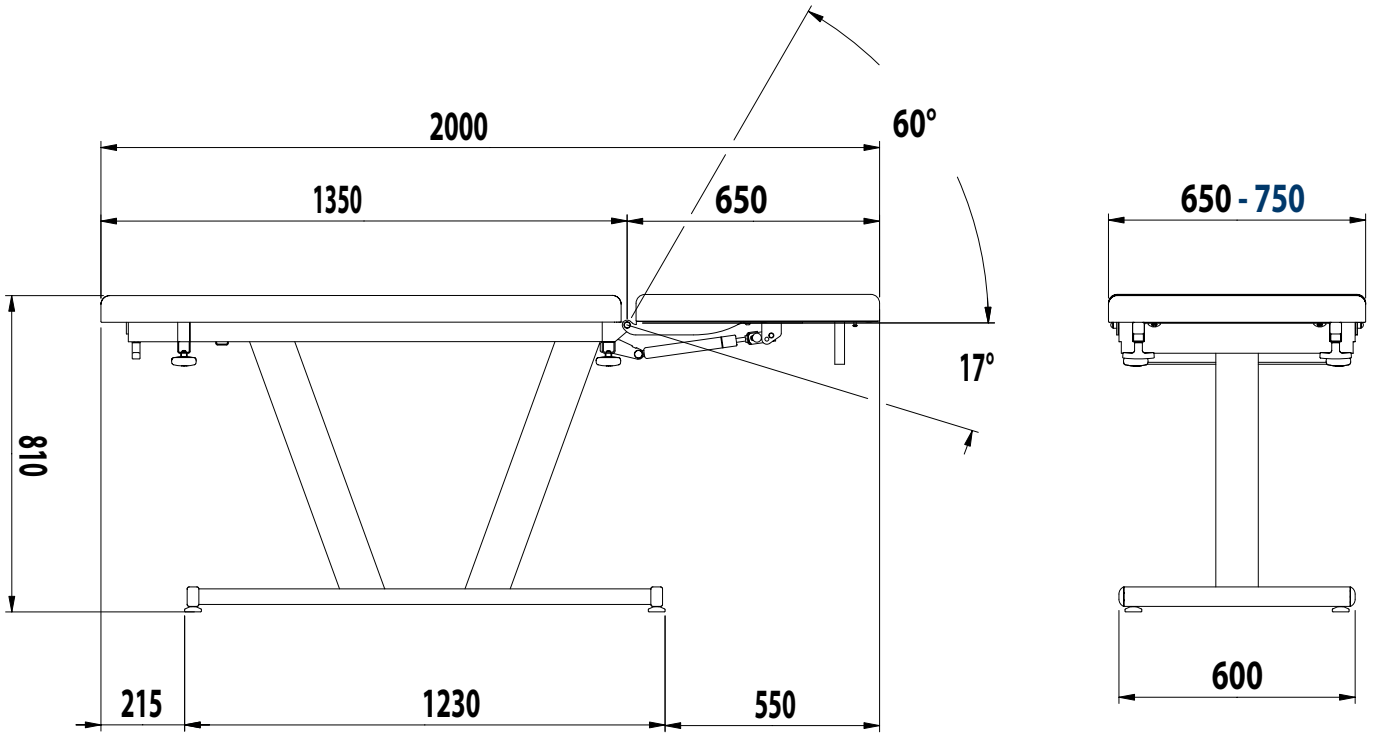

10110-10 + 600151-65

10110-10 + 600150-70

Notice d’utilisation – Divan d’examen

Caractéristiques

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage

Têtière réglable par vérin à gaz

Porte-rouleau papier,
longueur maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)

Utilisation prévue

Ce divan d’examen permet d’effectuer des actes de médecine générale tout en répondant aux contraintes majeures :

- La mise en position du patient de façon aisée
- La proximité maximale du médecin au champ opératoire

Seuls le Personnel soignant, agent de service hospitalier et des services Techniques peuvent manipuler ou utiliser le divan.

Le patient et accompagnateurs n’interviennent pas directement sur le divan. Ils n’accèdent pas aux commandes du divan.

Attention
Poids maximum du patient autorisé : **200 Kg** (testé à 800 kg en statique, têtière à 360 kg).

Montage du plan de couchage

Sellerie de dossier

X 6

Clé Allen n°4

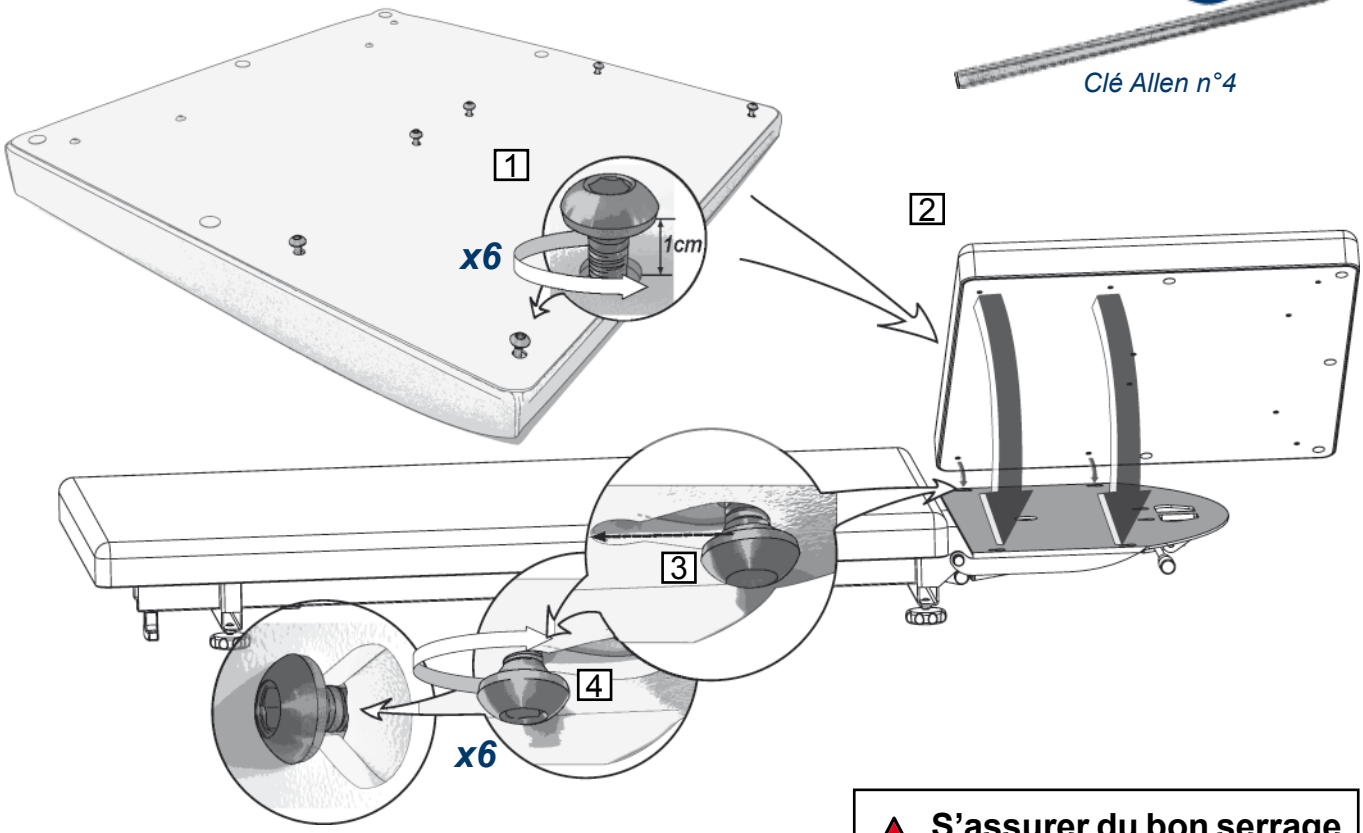

S'assurer du bon serrage avant l'utilisation

Sellerie d'assise

X 4

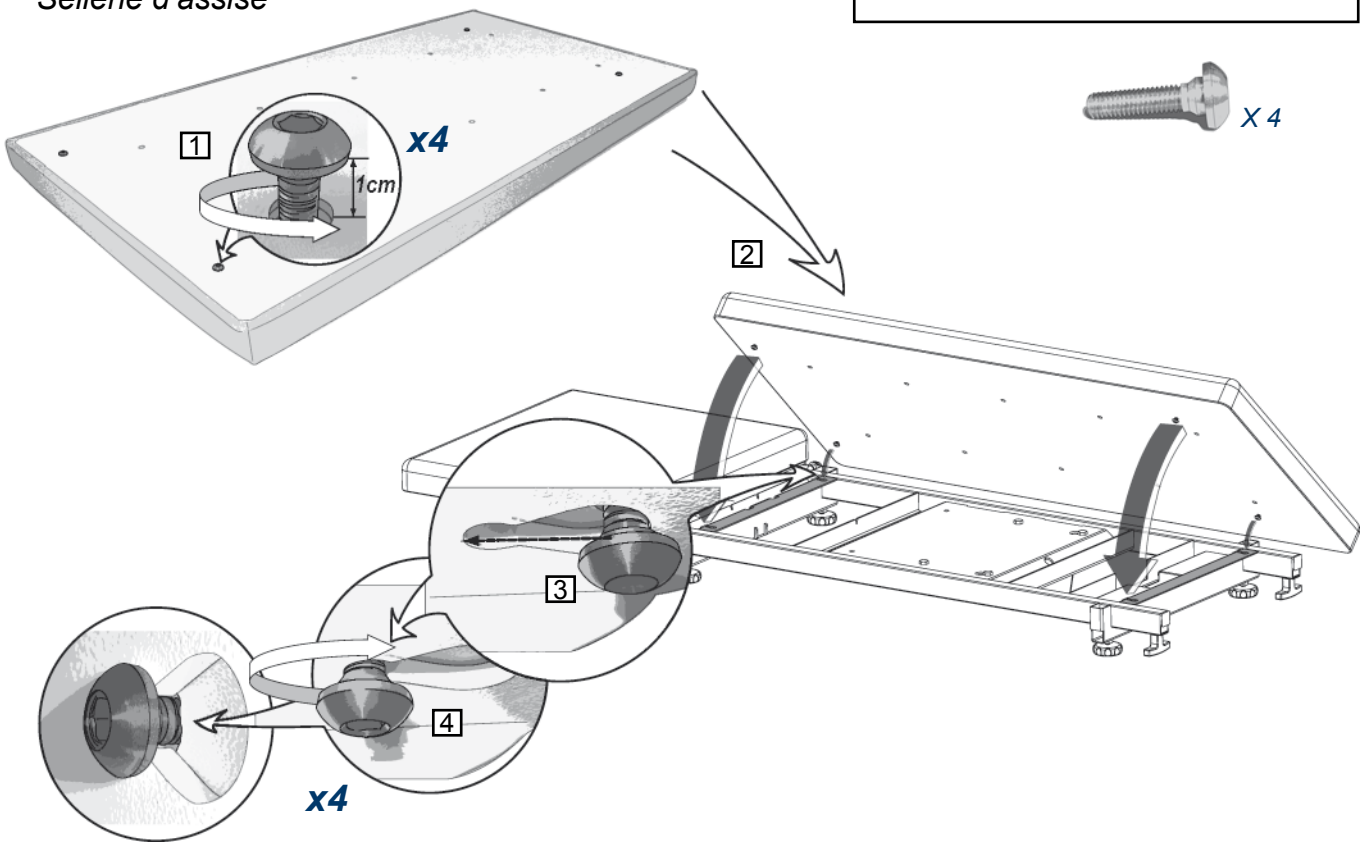

Utilisation du divan

Réglage de l'inclinaison de la têtière

D'une main, agir sur le levier **(L1)**, et à l'aide de l'autre main, abaisser ou relever le dossier suivant l'inclinaison désirée.

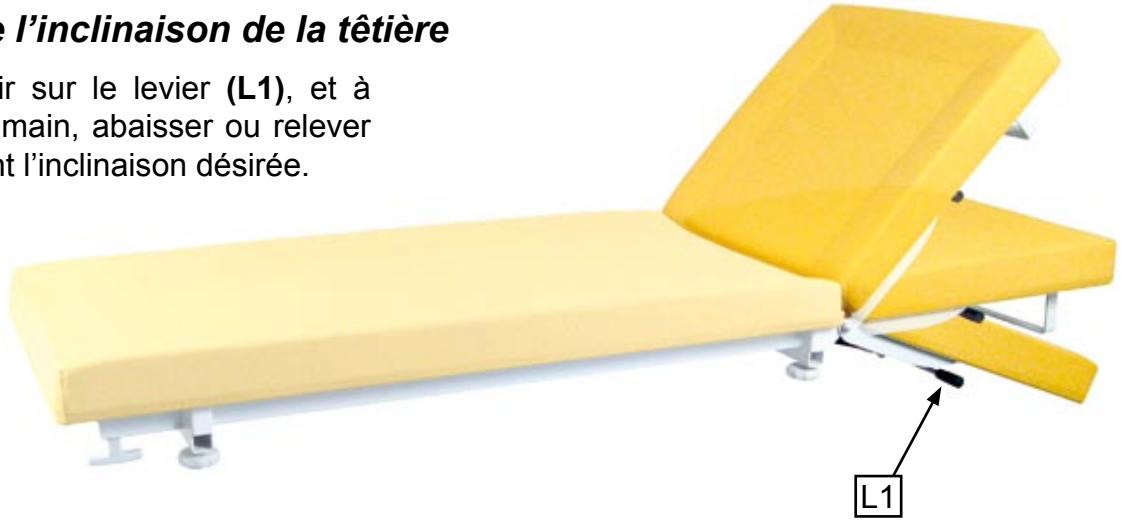

Le patient ne doit pas s'appuyer sur le dossier lors du réglage.

Rouleau papier

Installation du porte rouleau

Clé Allen n°4

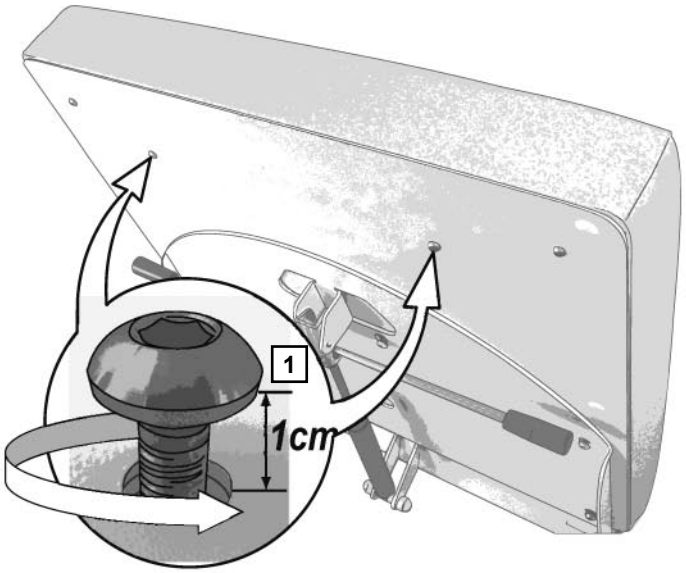

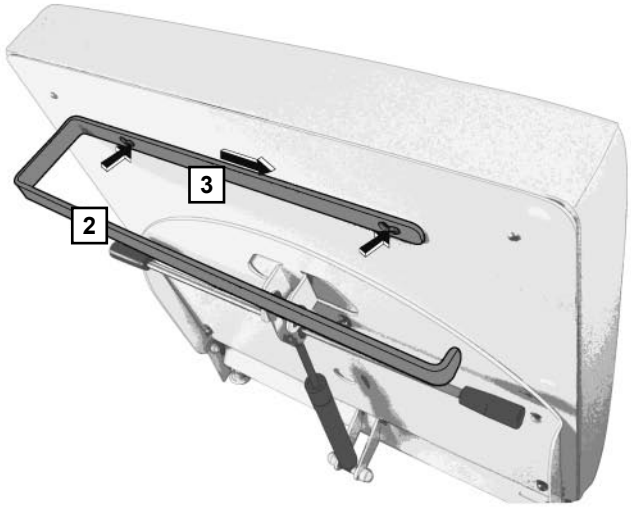

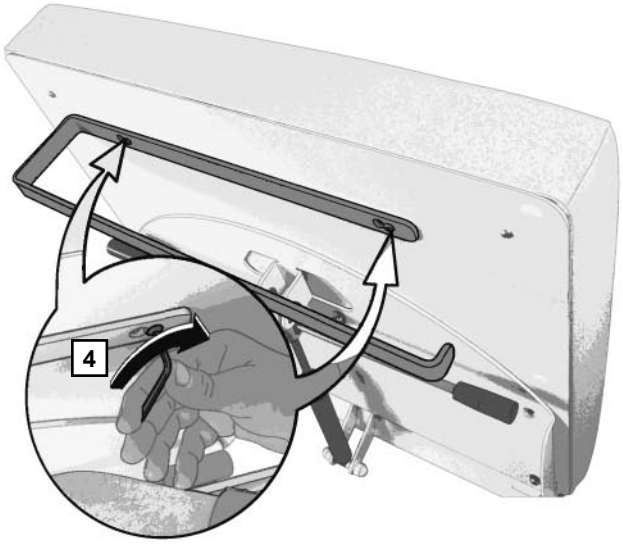

Mise en place du rouleau papier

Dérouler le papier sur les selleries avant que le patient ne s'installe sur le divan.

Attention bien suivre les indications fournies pour obtenir une plus grande longévité du matériel.

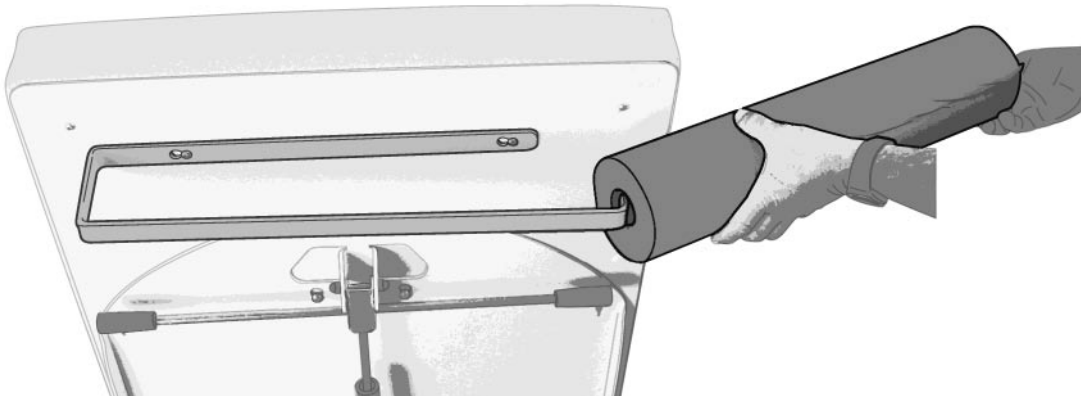

Réglage des patins

Soulever légèrement le divan. Visser ou dévisser le patin à la hauteur désirée.

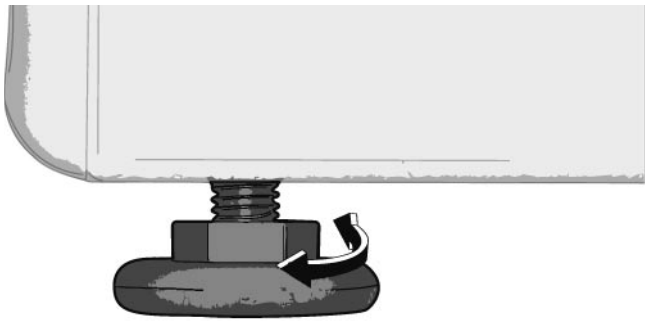

Accessoires

Étaux

(référence 166)

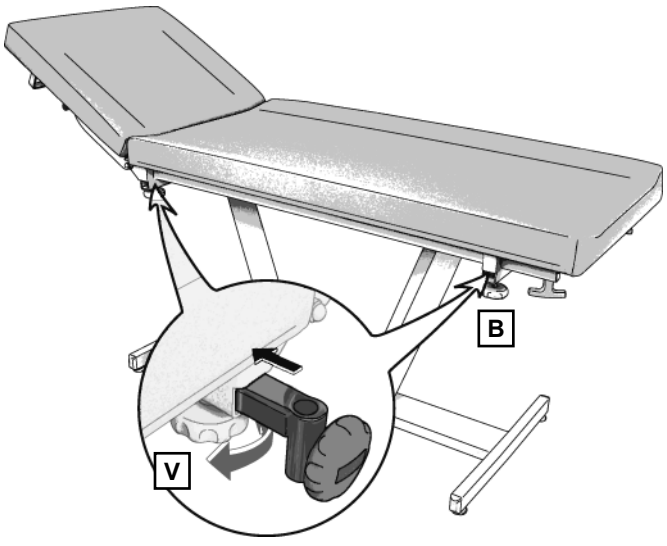

Mise en place des étaux

Enlever le bouchon **(B)** si nécessaire du tube carré. Desserrer les volants **(V)** et mettre en place la paire d'étaux *(référence 166 **(E)**)* dans les tubes carrés. Resserrer les volants.
Les étaux permettent la mise en place d'accessoires Diam. 16.

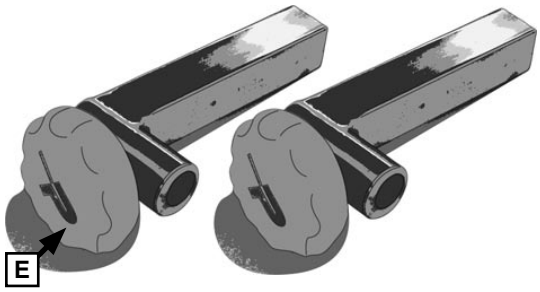

Repose-bras
(référence 2536)

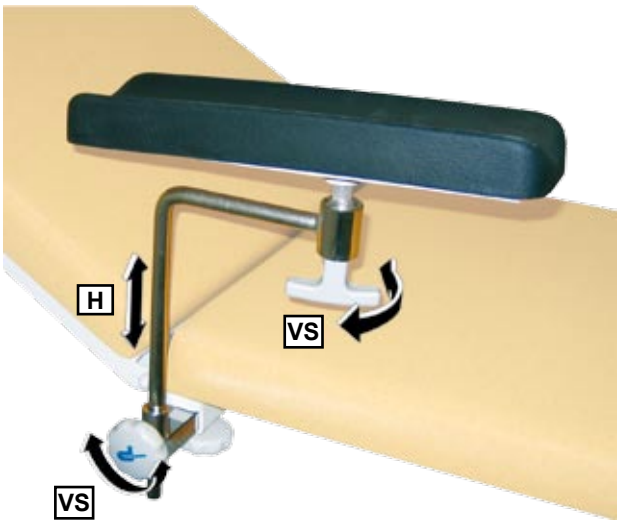

Réglage des appui-bras

Les appuis-bras standards se règlent en hauteur **(H)** et sont orientables dans toutes les directions grâce à une rotule située sous l'accoudoir. Pour les régler, il suffit de desserrer les volants de serrage **(VS)**, puis de les réorienter.

Attention
Resserrer les volants de serrage avant utilisation.
Ne pas s'appuyer sur l'extrémité des accoudoirs pour sortir du divan.

Attention
Le montage de ces accessoires nécessite l'emploi des étaux. (réf. : 166)

La paire d'étriers
(référence 850)

Mise en place des étriers

S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

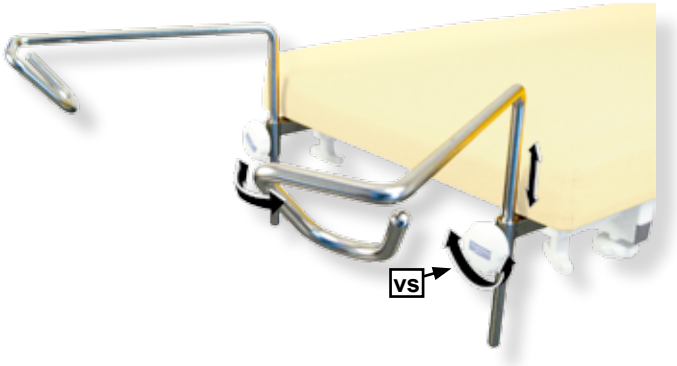

Attention
Le montage de ces accessoires nécessite l'emploi des étaux (réf. : 166)

La paire d'appui-jambes
(référence 840)

Mise en place des appui-jambes

S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

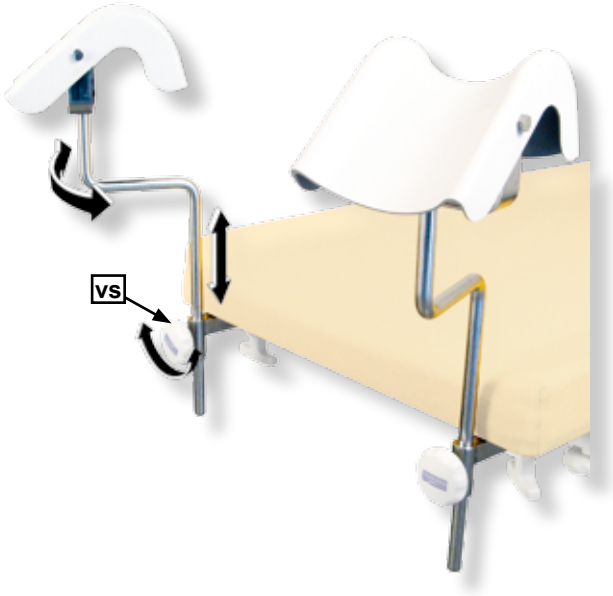

Attention
Le montage de ces accessoires nécessite l'emploi des étaux. (réf. : 166)

Porte sérum 2 crochets
(référence 985-01)

Mise en place du porte-sérum

S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

Attention
Le montage de ces accessoires nécessite l'emploi des étaux. (réf. : 166)

Porte sérum 2 crochets
(référence 2985-01)

Réglage en hauteur du porte-sérum

Le porte-sérum dispose de 1 tige coulissante.

Agir sur le verrou pour ajuster la hauteur de la tige supérieure.

Attention
Le montage de ces accessoires nécessite l'emploi des étaux. (réf. : 166)

Mise en place du porte-sérum

Dévisser le volant de serrage.

Introduire la tige porte sérum et visser

S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

Les barrières

(référence 85114-01)

Mise en place des barrières

1. Dévisser les volants de serrage.

2. Mettre en place les barrières. *Approcher les barrières de façon à obtenir un écartement de 25 mm entre les barrières et la sellerie.*

3. Resserrer les volants de serrage

Attention
25 mm (espace acceptable suivant norme ISO 13852 : 1996).

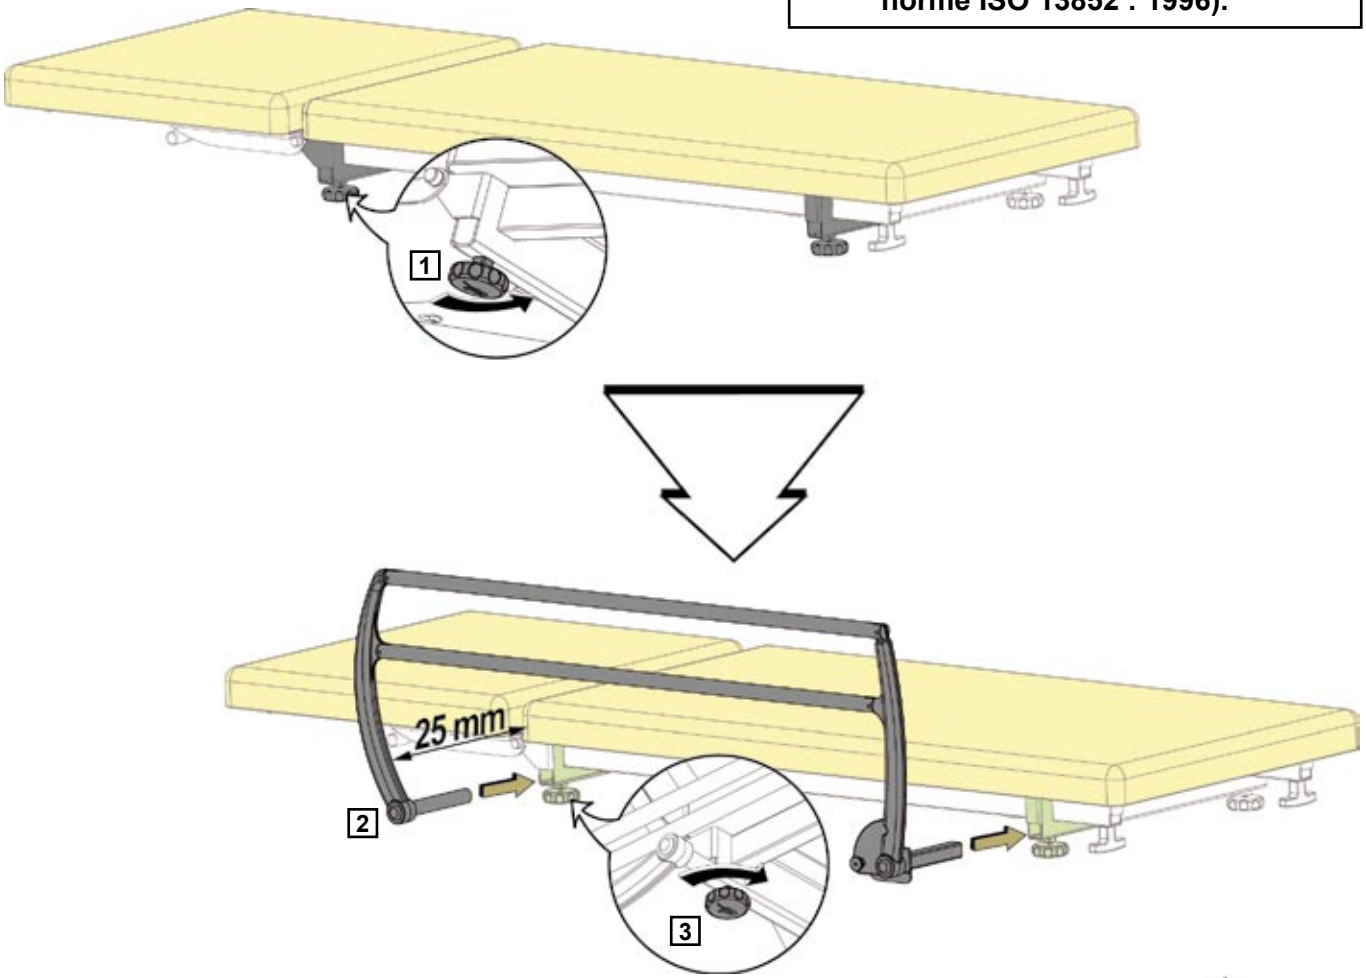

Utilisation de la barrière

Position haute

Saisir la barrière en sa partie supérieure et lever jusqu'à enclenchement du système.

Position basse

D'une main, maintenir la barrière en sa partie supérieure et de l'autre actionner la commande **(CB)** pour déverrouiller le système, puis l'accompagner jusqu'à sa position basse.

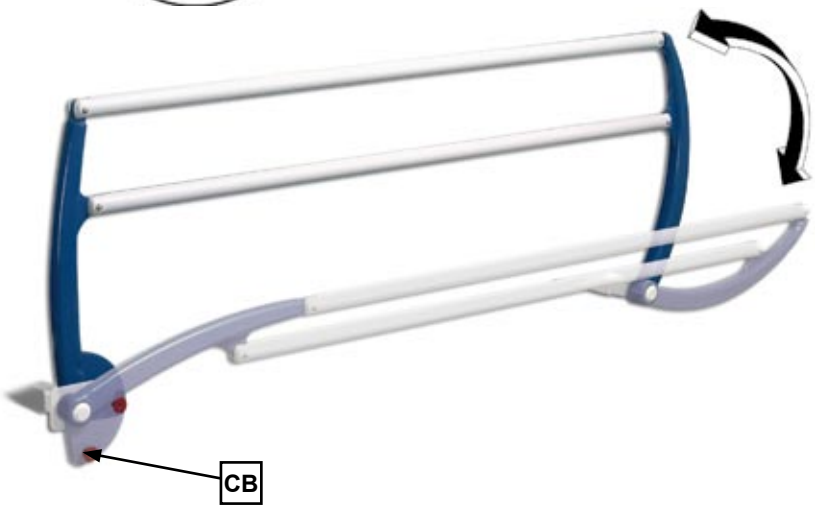

Vérifier que les barrières soient bien enclenchées avant utilisation.

Appui-tête
(référence 1102-10)

Rallonge de dossier
(référence 2055-01)

Installation du rallonge dossier

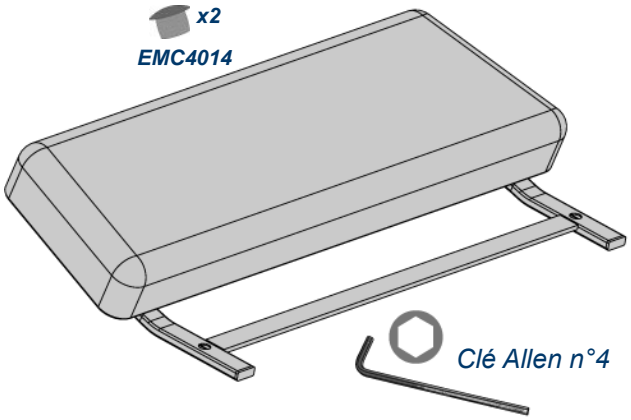

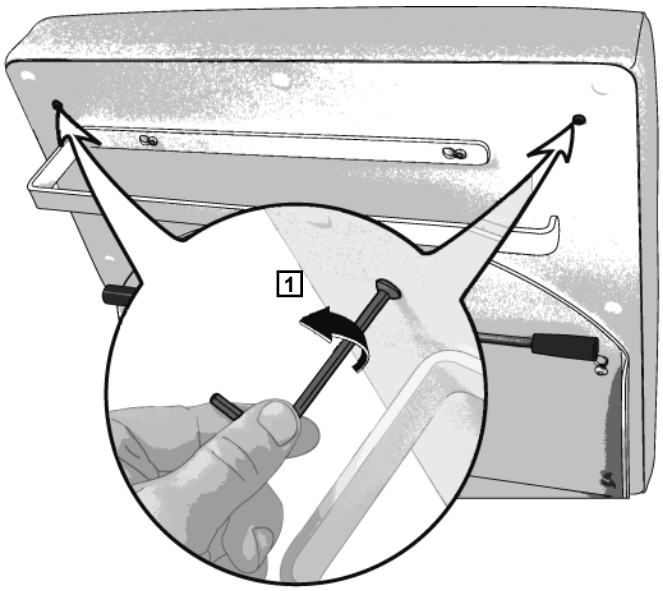

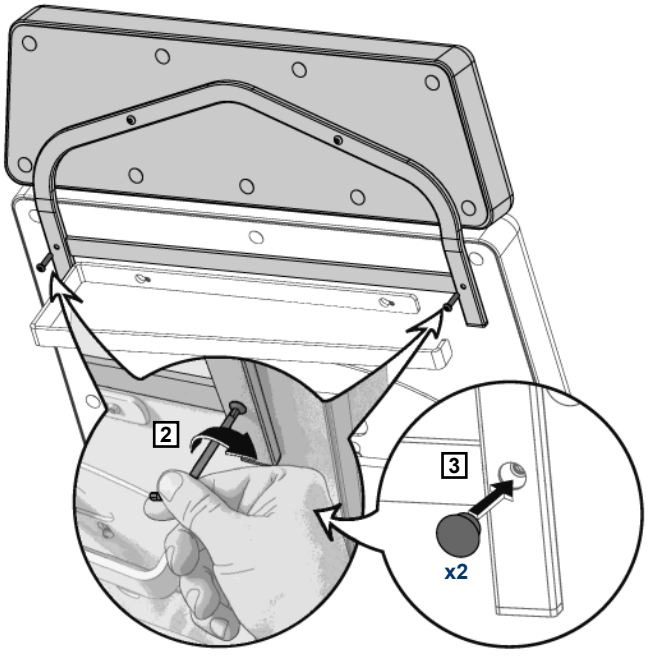

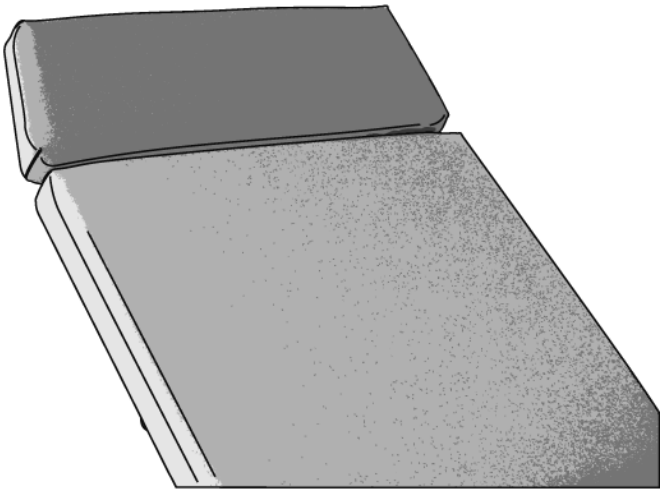

Appui-tête

(référence 2054-01)

Installation de l'appui-tête

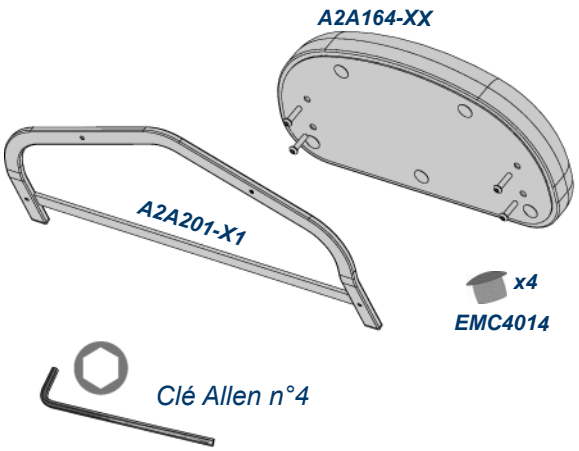

Clé Allen n°4

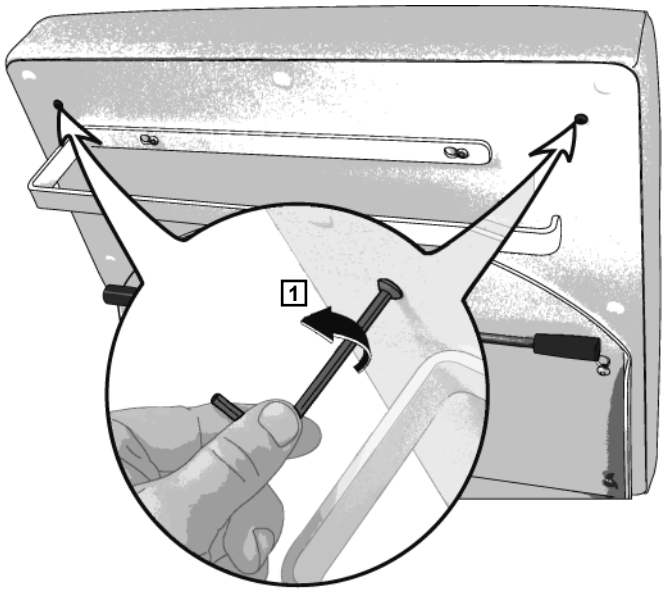

Montage du coussin pour les selleries 600150-65 et 600150-75

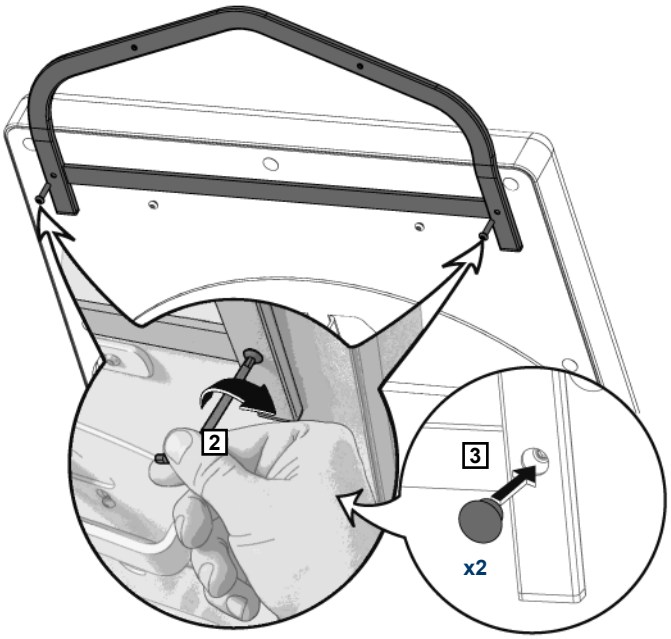

Montage du coussin pour la sellerie 600150-70

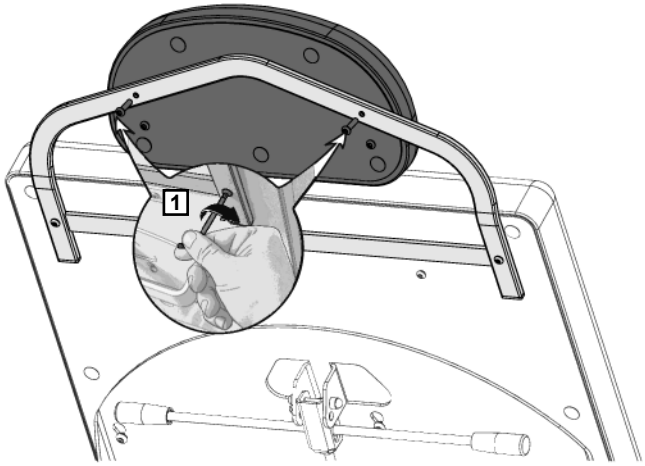

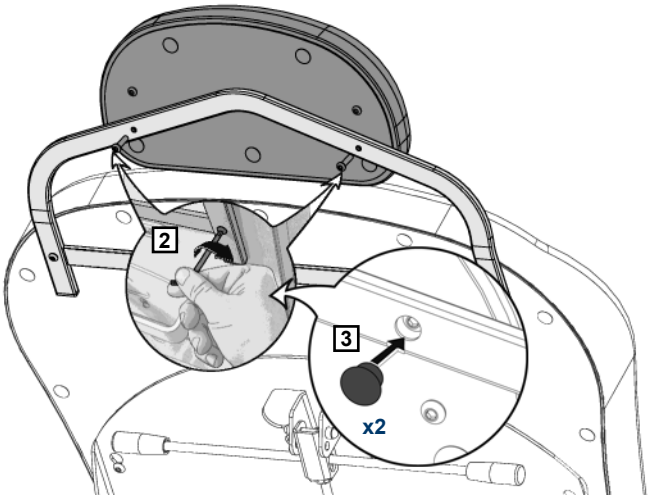

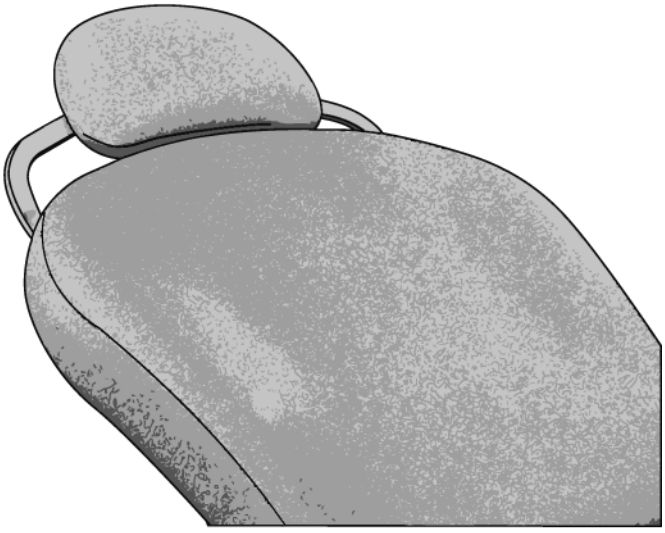

Porte rouleau réglable

(référence 2056-01)

Installation du porte rouleau

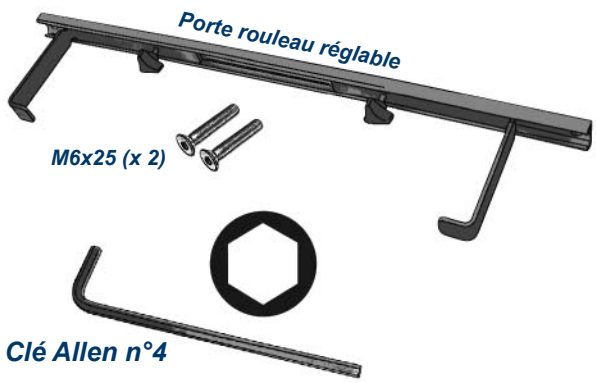

1. Démontage du porte rouleau existant

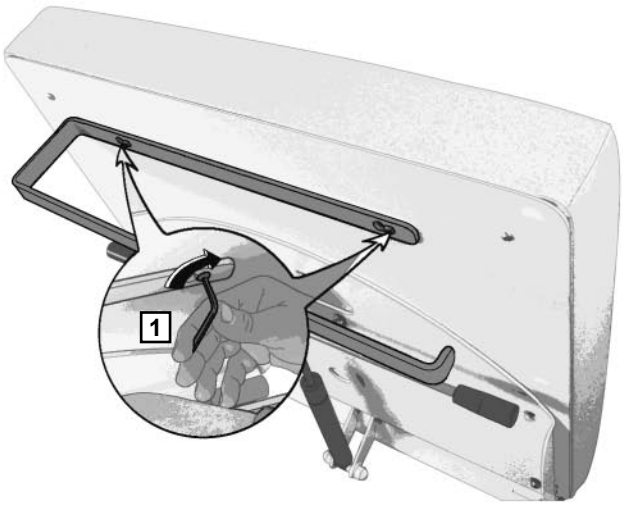

3. Remplacer par le porte rouleau réglable.

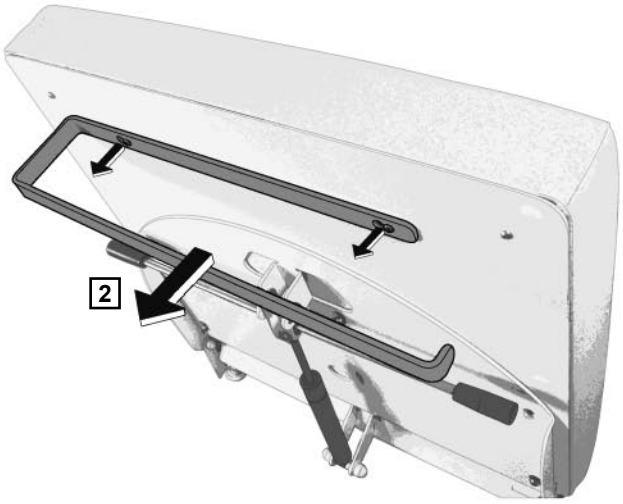

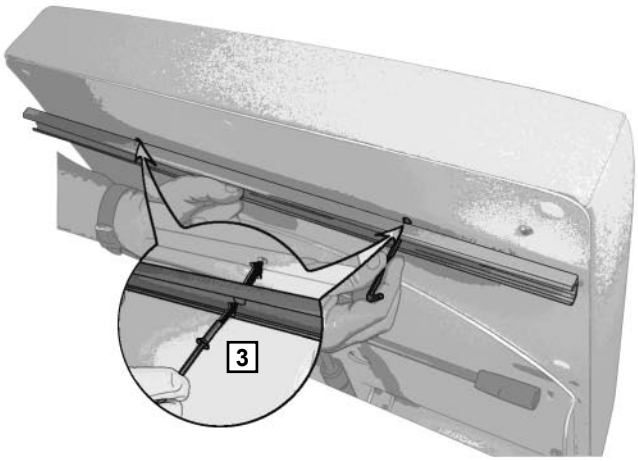

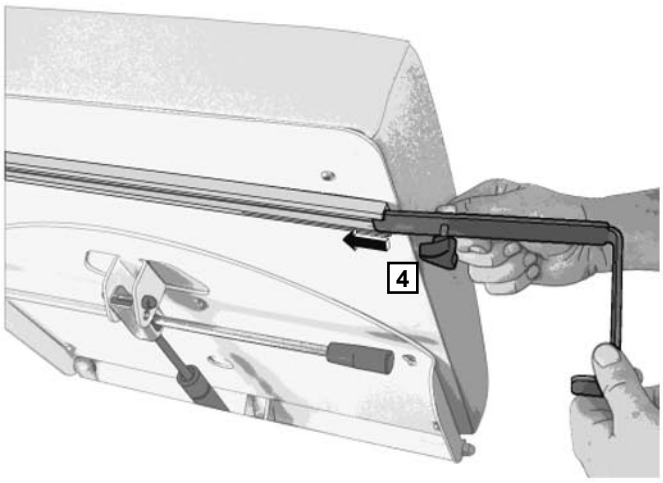

Installation du porte rouleau
[avec la présence de l'appui-tête (réf. : 2054-01)]

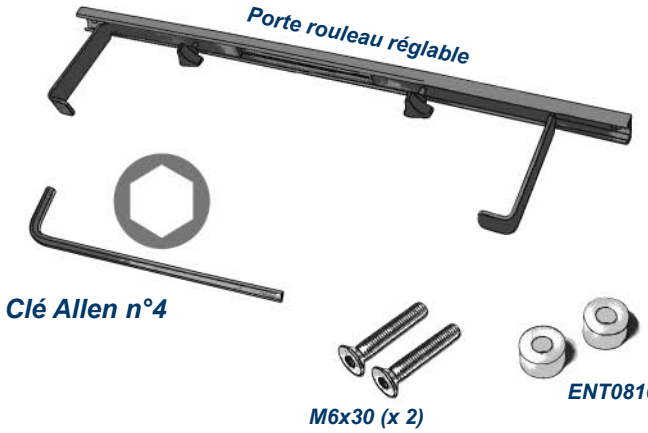

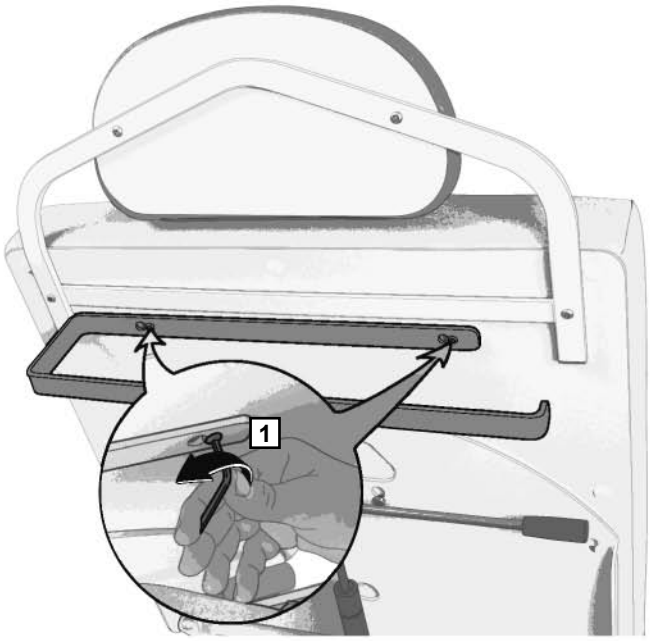

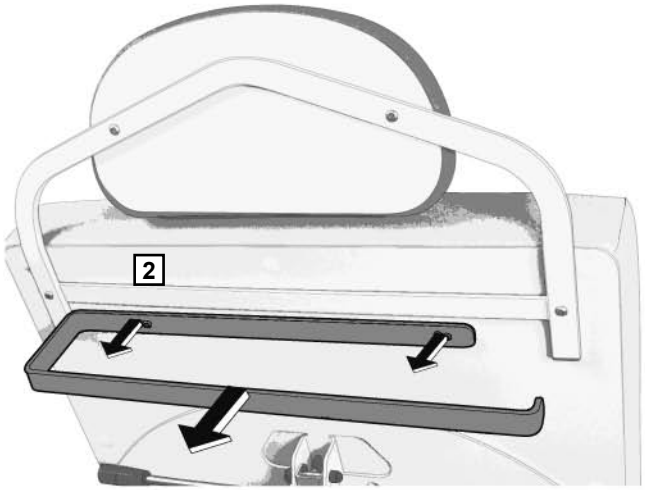

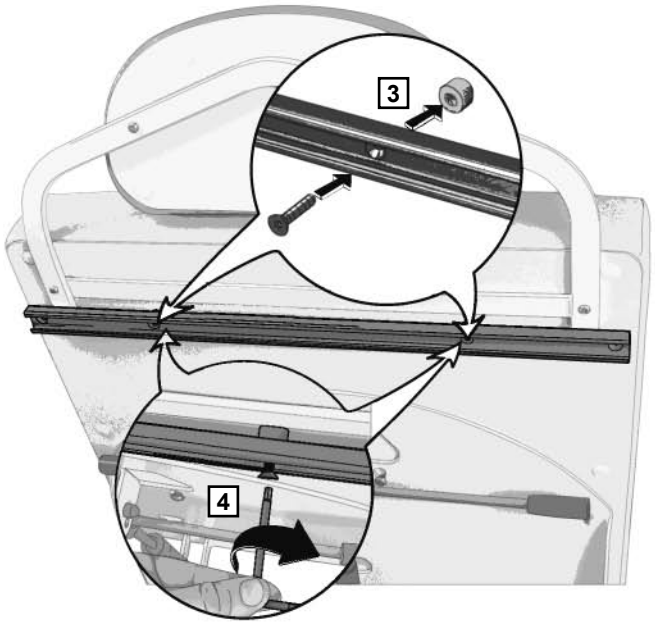

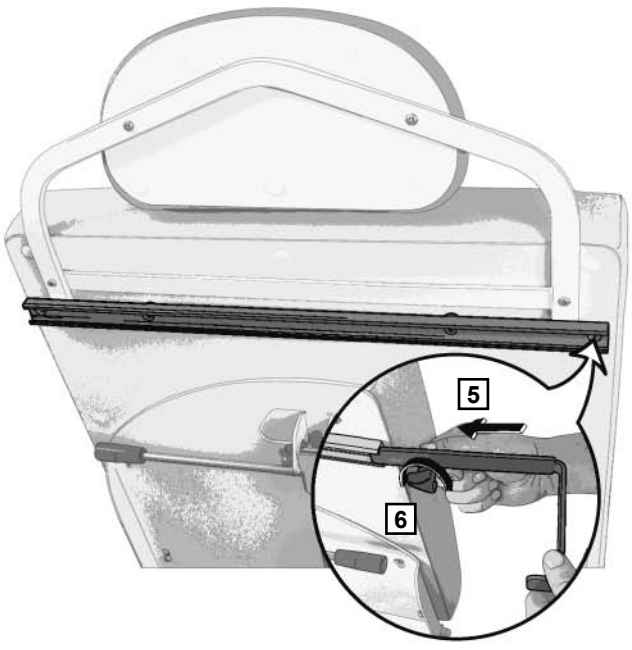

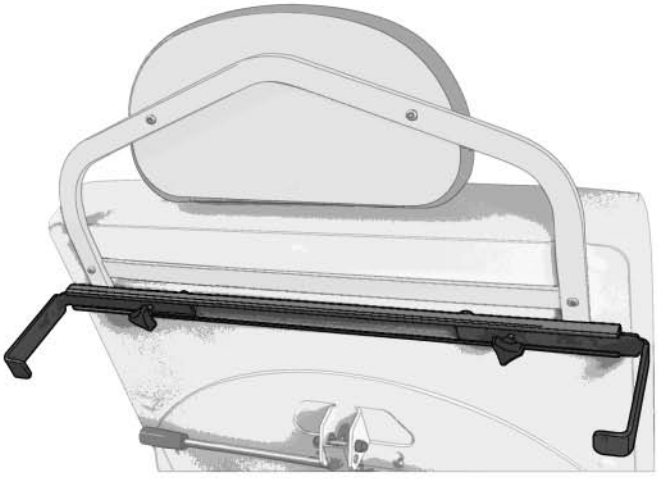

Mise en place du rouleau papier

Le rouleau papier se positionne sur un axe mobile avec à chacune de ses extrémités un système de crochet réglable.

1. Dévisser les volants de serrage **(VS)**.
2. Retirer légèrement le **1/2 (PR)**.
3. Insérer le rouleau papier.

Dérouler le papier sur les selleries avant que le patient ne s'installe sur le divan.

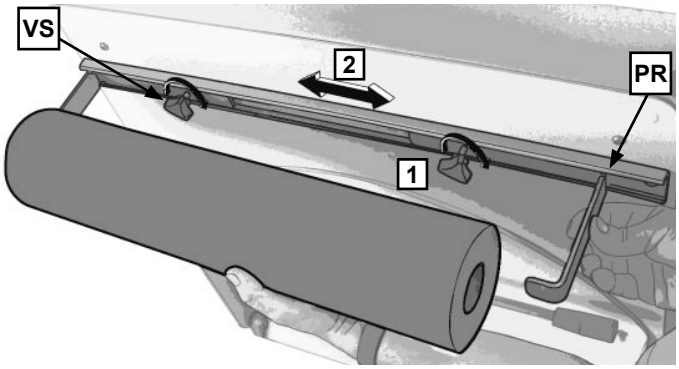

Porte rouleau

(référence 2057-01)

Installation du porte rouleau

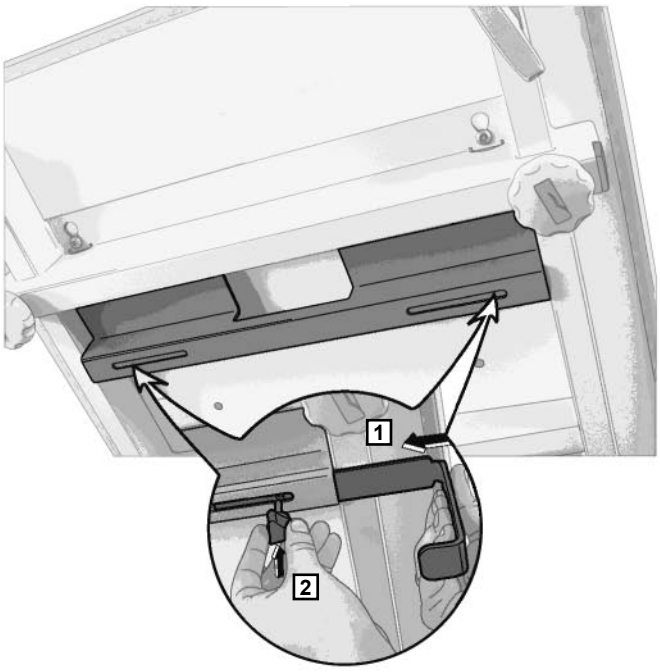

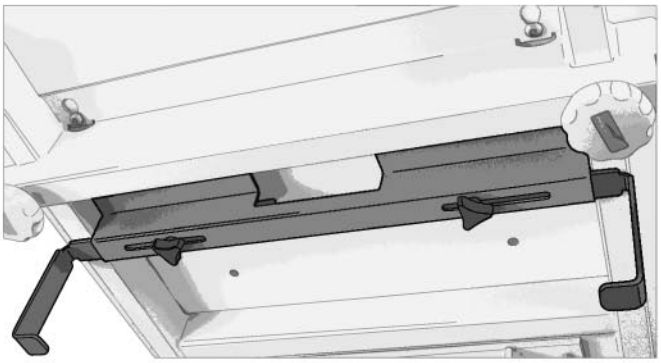

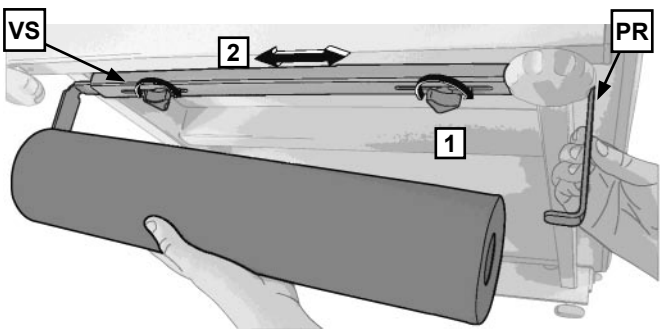

Mise en place du rouleau papier

Le rouleau papier se positionne sur un axe mobile avec à chacune de ses extrémités un système de crochet réglable.

1. Dévisser les volants de serrage **(VS)**.
2. Retirer légèrement le **1/2 (PR)**.
3. Insérer le rouleau papier.

Dérouler le papier sur les selleries avant que le patient ne s'installe sur le divan.

Coupe papier

(référence 2052-65 et 2052-75)

(référence en fonction de la sellerie choisie au moment de l'achat) ***(Incompatible avec la sellerie 600150-70)***

Mise en place du coupe papier

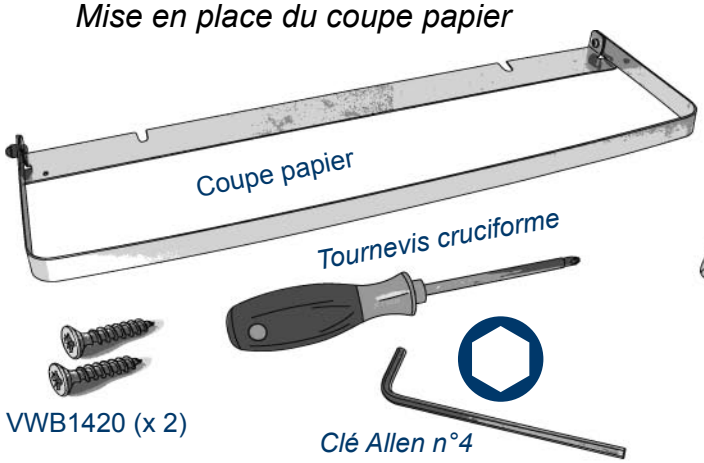

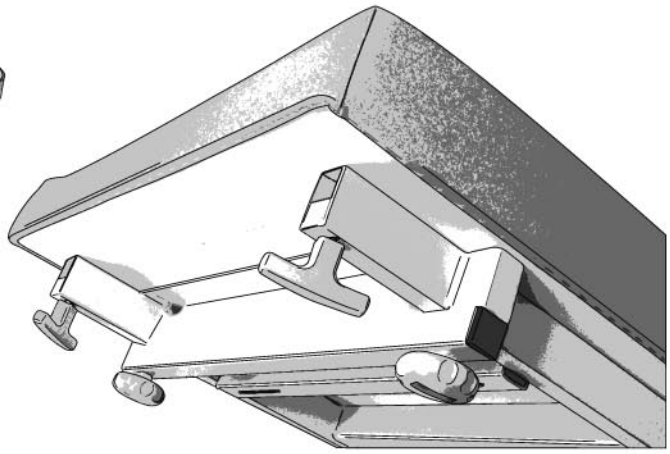

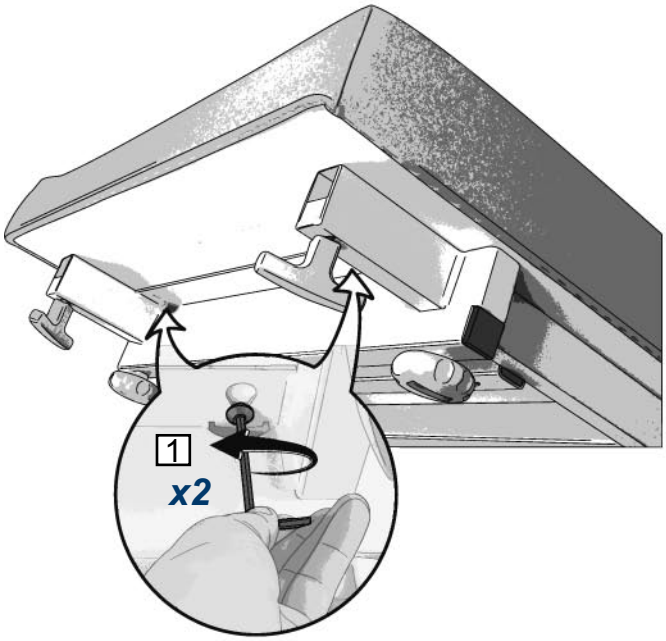

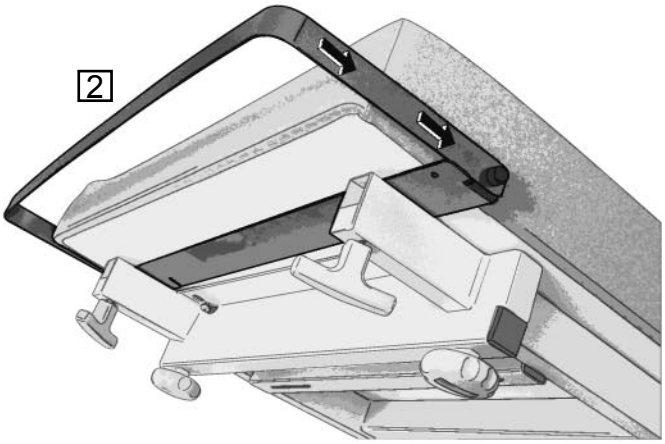

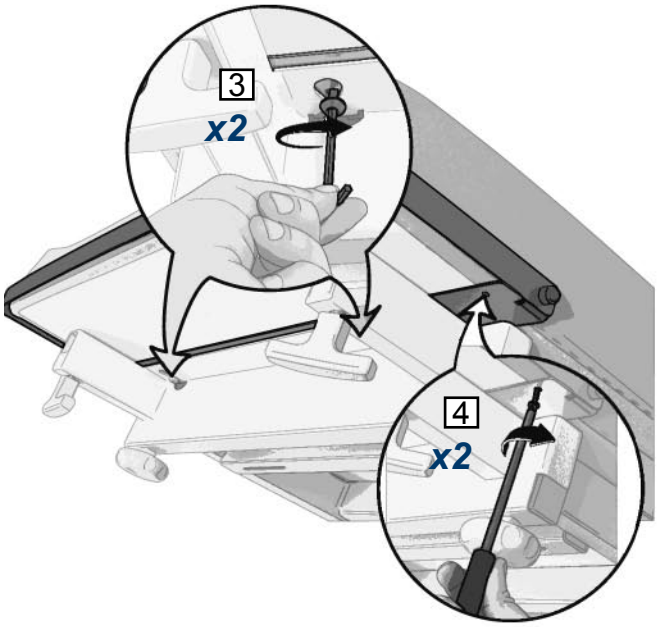

S'assurer du bon serrage avant l'utilisation

Utilisation du coupe papier

1) faire glisser le papier sous le coupe papier.
2) rabattre le coupe papier.

Options

Trou pour visage
(référence 2230)

Uniquement pour les référence de selleries suivantes : ***600150-65***
600150-75

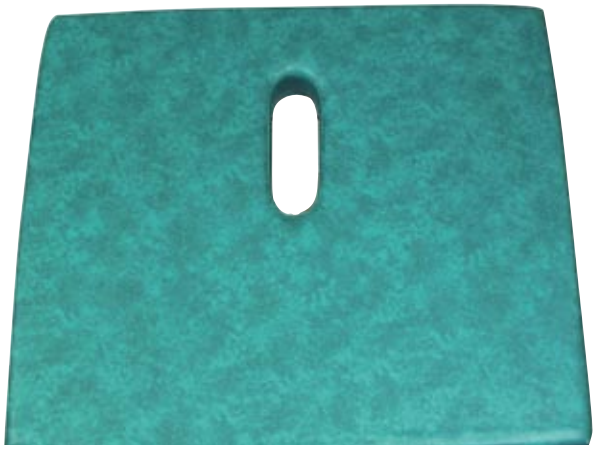

Durée de vie du divan d’examen

Ce matériel a été conçu pour une durée de vie de 10 ans (sauf pièces d’usures) dans des conditions normales d’utilisation. Cette durée peut varier selon la fréquence d’utilisation.
VERIFIER AU MOINS UNE FOIS PAR AN L’ETAT GENERAL DU DIVAN D’EXAMEN.

Composants interchangeables d’usures

Pour toutes interventions, contacter votre revendeur habituel, en indiquant le numéro de série se situant sur l’étiquette à l’arrière du divan d’examen.

Maintenance obligatoire / spécifique

Une fois par an :

- Vérifier le bon serrage des vis et des bielles.
- Vérifier l’état des fixations des parties articulées.
- Vérifier quel la structure n’a subi aucune déformation.
- Contrôler les différentes liaisons (jeu excessif, bruit...)
- Noter ces informations et la date de vérification sur le carnet d’entretien.

Avertissement matériel
NE PAS DÉMONTER L’APPAREIL
Si un défaut est détecté, contacter immédiatement votre revendeur ou le service technique de la société de votre revendeur (cf. Chapitre Garantie) pour un diagnostic complet. Si un doute subsiste, ne pas utiliser l’appareil.

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

Carnet d'entretien

Référence du produit :
N° de série du (cf. étiquette) : .....
Date de fabrication du (date de départ de la garantie) : .../.../...

Date	Nom du technicien	Type d'intervention - action corrective

Si retour du produit chez le revendeur ou le fabriquant, merci de bien vouloir nettoyer et désinfecter le matériel.

Notes

Notes

Renseignements sur la garantie

Garantie

Promotal garantit les matériels fabriqués par Promotal et leurs composants pendant une période de deux (2) ans à la date de facturation.

Engagements

Promotal s'engage à remplacer les pièces défectueuses qui lui sont retournées au cours de la période applicable de la garantie, et qui, après examen par Promotal, s'avèrent défectueuses.

Le distributeur de Promotal est responsable du service après vente pendant et après la période de garantie.

Exclusions

- Cette garantie ne s'applique pas :
  (1) aux selleries*;
  (2) aux matériels endommagés par accident, abus, négligence ou pendant le transport ou la manutention;
  (3) aux matériels endommagés suite à une installation ou opération de maintenance impropre à son utilisation ou par un raccordement à une source électrique impropre;
  (4) aux éventuels matériels consommables.
- Les modifications ou altérations de matériels Promotal ou de leur composants (y compris l'installation d'équipements non-Promotal), sauf autorisées par Promotal, annuleront cette garantie.
- Le déplacement ou l'enlèvement de joints et/ou de l'étiquette d'identification des produits ou des composants annulera également cette garantie.

Obligation exclusive

Le seul engagement de Promotal sous la période de garantie est le remplacement des pièces défectueuses. Promotal ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou fortuits, ou des pertes subies suite à la non utilisation des matériels.

Absence d'autorisation

Aucune personne ou société n'est autorisée à créer tout autre engagement ou obligation relatifs aux matériels au nom de Promotal.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE DE PROMOTAL AU DETRIMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE.

* Les selleries sont garanties **1 an** contre des **vices de fabrication**

DECLARATION DE CONFORMITE

CE

Nom de l'entreprise : ***Promotal***

Adresse de l'entreprise : *22, rue de St. Denis de Gastines*
53500 Ernée
FRANCE

L'article référence : **10110-10**
Porte une étiquette CE.

Description du produit : **Divan d'examen**

Ce marquage atteste que ce dispositif médical, de classe I :

est conforme aux dispositions réglementaires définies par les exigences essentielles de sécurités et de santé de la directive 93/42 CEE, annexe I et VII (décret 95-292 du 16 mars 1995).

satisfait aux normes Européennes qui lui sont applicables.

Fait à Ernée,
Le 12 janvier 2009

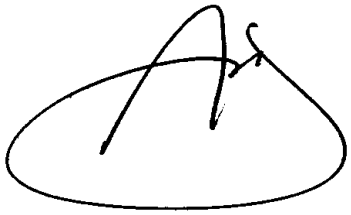

François NOGRIX
Président

Promotal
22, rue de Saint Denis de Gastines, 53500 Ernée - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 43 05 17 76, Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00, www.promotal.com

S.A.S. au capital de 4 290 660 € - R.C.S. LAVAL Siret 421 156 720 00011 - TVA FR 67 421 156 720 - APE 331B

Depuis plus de 40 ans, ***PROMOTAL*** a bâti sa réputation sur la qualité de ses produits pour la plus grande satisfaction des praticiens, personnels hospitaliers et… patients.

PROMOTAL propose une gamme complète de mobilier médical : brancards, fauteuils de dialyse ou de prélèvement, divans d'examen, tables gynécologiques…

distrimed.com
Le matériel médical sur le net

CE

PROMOTAL - FRANCE
www.promotal.com

MIDMARK

DIC10110-10_1809FR